

1. OBJET

Prévention de l'accouchement prématuré spontané : indications et modalités de prescription de la Progestérone Vaginale, place du cerclage cervical et du pessaire.

2. DOMAINE D'APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE


Domaine d'application : le pôle Femme-Enfant


Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes

3. RESPONSABILITES

Les médecins du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne application du document.

4. DESCRIPTION DE L'OBJET

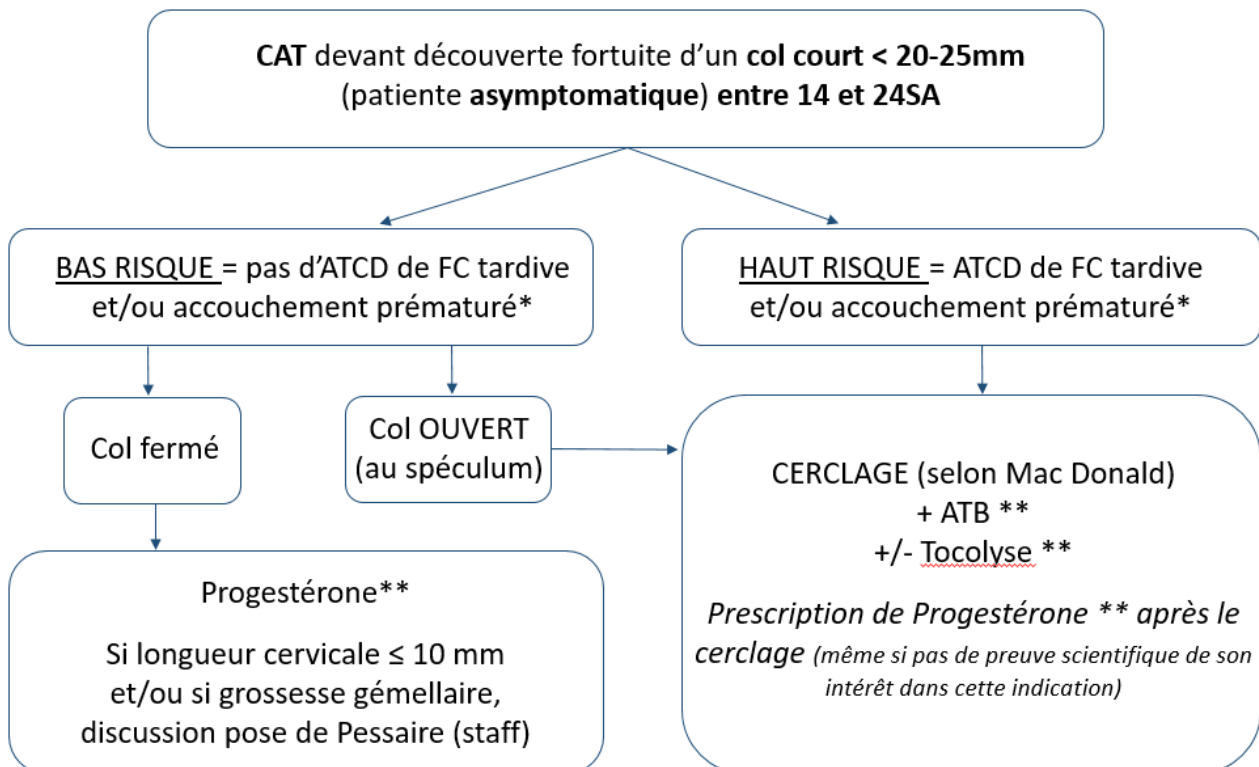

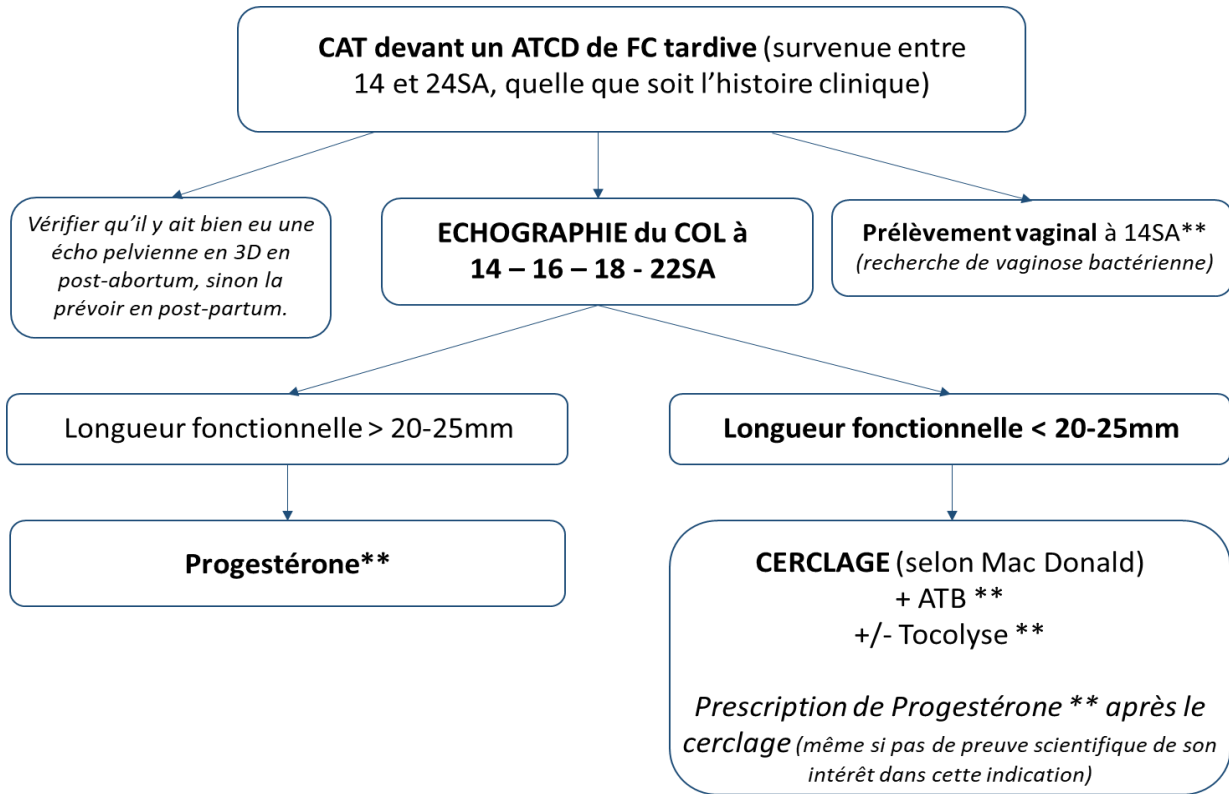


* - Accouchement prématuré : travail spontané < 34 SA

** - Traitement de la vaginose bactérienne : **Métronidazole** PO 500 mg x 2/jour 7 jours OU Clindamycine PO 300 mg x 2/jour 7 jours

- **Progestérone** : 100 mg/jour, capsules vaginales, à partir de 14 SA jusqu'à 36 SA

- Antibiothérapie pour cerclage : **Rocéphine**® 1g/jour pendant 48h (débuté à l'admission de la patiente)

- Tocolyse pour cerclage **UNIQUEMENT SI TERME > 20 SA** : **Adalate**® 1cp toutes les 8h pendant 48h (premier cp donné avant le départ au bloc)

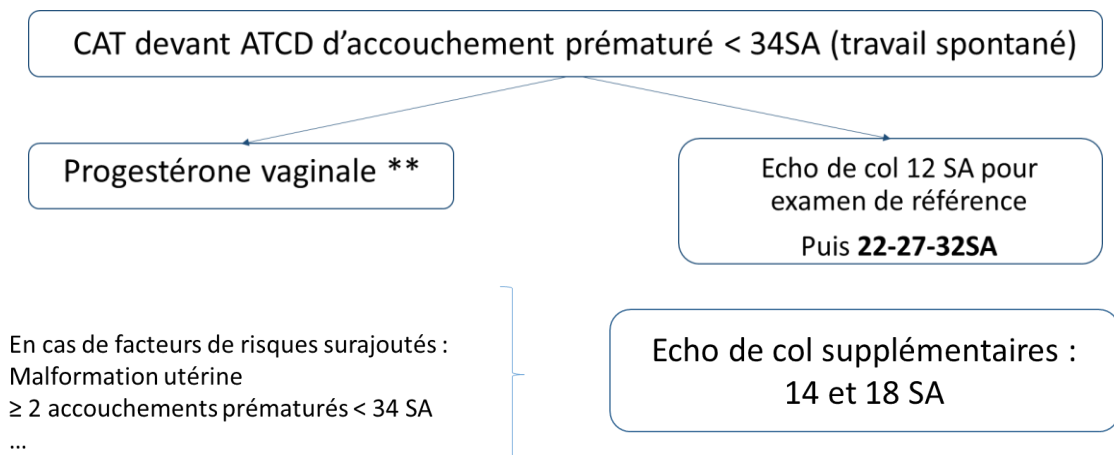

CAS PARTICULIERS

- **ATCD \geq 2 FC tardives / accouchements prématurés** (travail spontané < 34SA) :
 - Indication à un **cerclage prophylactique entre 14 et 16SA** selon **Mac Donald**.
- **ATCD de FC tardive malgré cerclage type Mac Donald :**
 - Indication à un **cerclage prophylactique cervico-isthmique** par voie vaginale
 - Cerclage abdominal à discuter en fonction du contexte clinique (avis staff)
- **Antécédent de FC tardive/accouchement prématuré + autre facteur de risque** (ex : malformation utérine, ...) : **Avis STAFF OBSTETRICAL**

SURVEILLANCE POST-CERCLAGE

- **Examen au speculum 1/mois en consultation, +/- échographie du col** : recherche d'une ouverture du col malgré cerclage.
- **Indications d'hospitalisation :**
 - Contractions utérines nécessitant une tocolyse (avec ou sans modifications cervicales)
 - Mise en évidence d'un col ouvert malgré cerclage.

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES

Références internes : Protocoles MAP et prévention des infections maternofoetales 2011

Références externes :

Romero R et al. Vaginal progesterone in women with an asymptomatic sonographic short cervix in the midtrimester decreases preterm delivery and neonatal morbidity: a systematic review and metaanalysis of individual patient data. Am J Obstet Gynecol 2012; 206:124.e1-19.

RPC CNGOF 2014 : Pertes de grossesse

RPC CNGOF 2016 : Prévention de la prématurité

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Groupe de travail : Dr J Huet, Dr A.S Lafitte, Pr M Dreyfus

<i>Dernière version</i>	<i>Objet de la révision</i>
03 - 22 juin 2023	06 juin 2023 - MAJ du contenu avec présentation en organigramme
<i>Historique des révisions</i>	
01 - 18 nov. 2013 - création du document sous format électronique, 02 - 12 août 2014	

7. DIFFUSION

Destinataires (liste, fonction/service et/ou nom)

Chef de Service - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Chef de Service - CHU\POLE FEMME ENFANT\Néonatalogie, Médecin - CHU\POLE FEMME ENFANT\Néonatalogie, Qualiticien - CHU\DIRECTION DE LA QUALITE, GESTION DES RISQUES ET DES USAGERS\Qualité Gestion des Risques, Cadre de santé - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Médecin - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique

8. EVALUATION

Néant

CYCLE DE VALIDATION		
Rédaction	Vérification	Approbation
Justine HUET Médecin - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 11 juin 2023 11:51:21	Christine DENOUAL ZIAD Chef de Service - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 22 juin 2023 15:50:36	Aurore BOUQUEREL (par Marc MANGIN) Directeur - CHU\DIRECTION DE LA QUALITE, GESTION DES RISQUES ET DES USAGERS 22 juin 2023 15:54:52

Références : Pessaire-cerclage type ASQ perforé

- Mesures : grand diamètre 65/ hauteur 21/ petit diamètre 35
- Certification conformité européenne : CE0482, MED/CERT ISO 9003/EN 46003
- 65/21/35 ASQ 65/21/35 PZN: 480 57 23
- Prix unitaire (sur site) : 39,71 euros
- Adresse du fournisseur : **Dr. Arabin GmbH & Co. KG**, Alfred-Herrhausen-Str. 44 | D • 58455 Witten. Tel : +49 (0)2302 189214 | F +49 (0)2302 189216. www.dr-arabin.de / Email: info@dr-arabin.de
- codage de la pose JLLD001